

Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

REPORT ANALITICI SUI CAMPIONI ESAMINATI



Dott. ANTONIO BALZANI
SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
PROTEZIONE AMBIENTALE - PREVENZIONE INCENDIO
CHIMICO IGIENISTA INDUSTRIALE
CERTIFICATO IIC
AIDII 02008 AIAS 145



mail: gsa@rsadvnet.it – a.balzani@live.it

associato




AIDII
associazione italiana degli Igienisti Industriali
per figure industriali e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

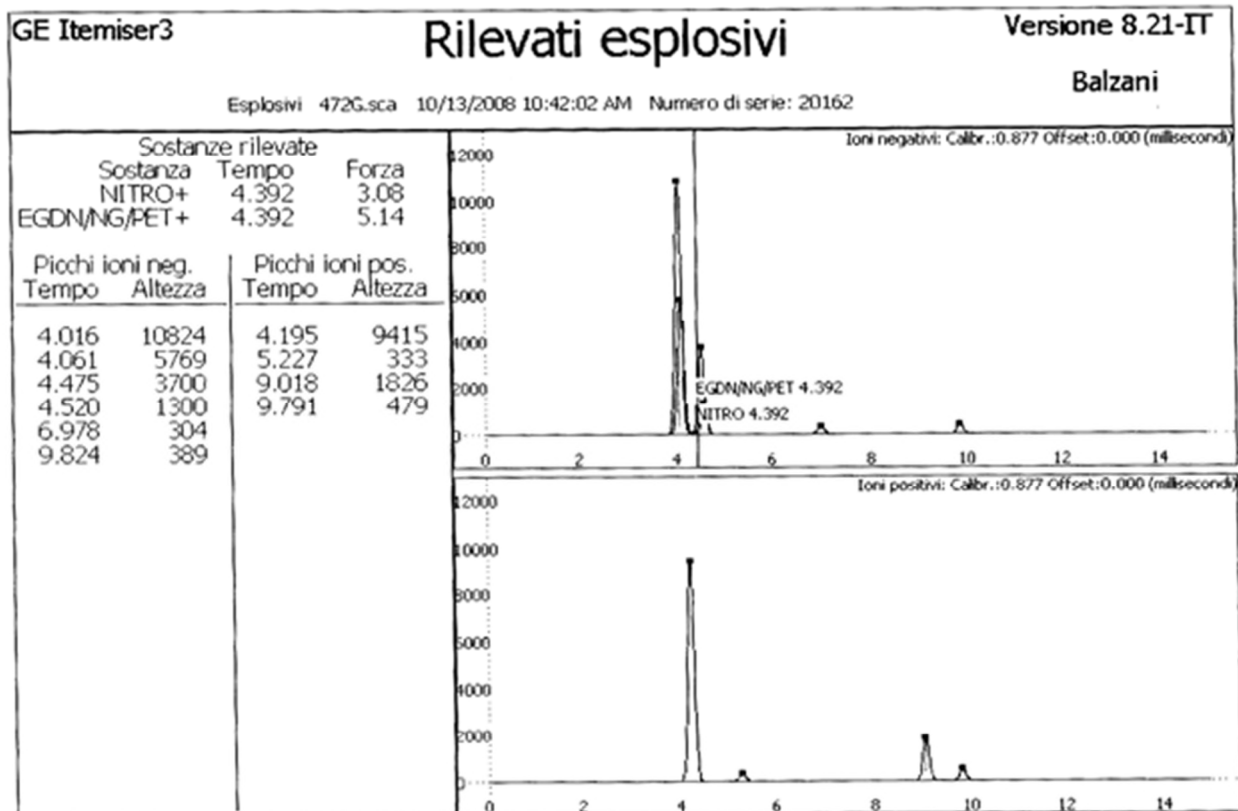

Note: 472G

Nome file: 472G.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:42:02 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:40:47 AM

Numero di serie: 20162

Esposivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.877 Offset: 0.000

P-Cal: 0.877 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	6.945 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.392 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.268 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.121 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
	3.870	4.414 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	8.080 -0.040 0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	6.400 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	4.652 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	5.064 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	4.095 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/PE	3.851	4.392 -0.120 0.120	600	500	Neg
P MNT	5.385	6.142 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	6.299 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	5.848 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	6.360 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	6.111 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc. BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

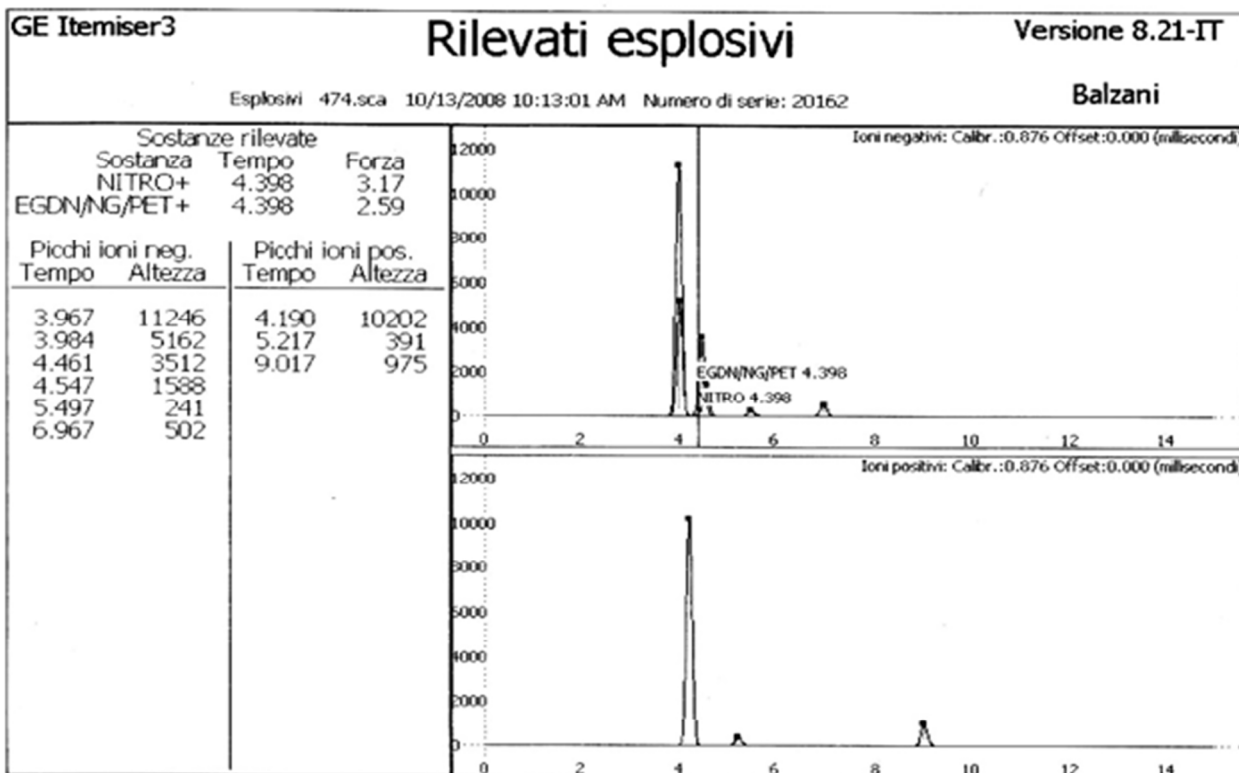

Note: 474

Nome file: 474.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:13:01 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:08:14 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.876 Offset: 0.000

P-Cal: 0.876 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.	All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	6.954 -0.060	0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.398 -0.120	0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.278 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.134 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
HMX	3.870	4.420 -0.100	0.100	1200	1000	Neg
DNT	7.084	8.091 -0.040	0.040	750	750	Neg
TATP	5.611	6.408 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
TATP2	4.079	4.659 -0.040	0.040	1000	1000	Pos
DMNB	4.440	5.071 -0.040	0.040	1000	1000	Pos
EGDN/NG/PE	3.590	4.100 -0.050	0.050	2000	2000	Neg
P MNT	3.851	4.398 -0.120	0.120	2000	500	Neg
P MNT 2	5.385	6.150 -0.040	0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.523	6.308 -0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.127	5.856 -0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.576	6.369 -0.040	0.040	750	750	Neg
	5.358	6.120 -0.040	0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

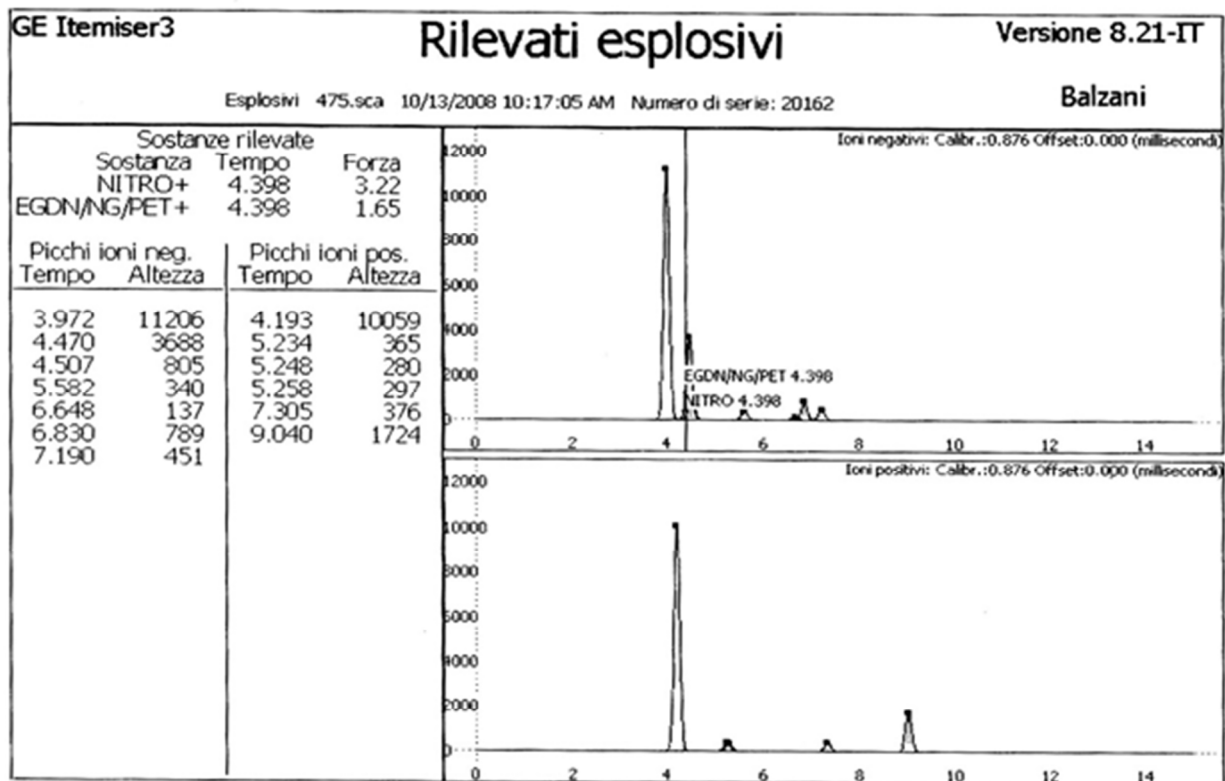

Note: 475

Nome file: 475.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.	All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	6.955 -0.060 0.040	600	550	Neg	
Tempo: 10/13/2008 10:17:05 AM	NITRO	3.851	4.398 -0.120 0.120	1000	500	Neg	
Calibr.: 10/13/2008 10:08:14 AM	RDX	6.372	7.278 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	9.134 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Esplosivi Ottimizzato		3.870	4.420 -0.100 0.100	1200	1000	Neg	
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	8.091 -0.040 0.040	750	750	Neg	
Avvisi:	DNT	5.611	6.409 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Utente: Balzani	TATP	4.079	4.659 -0.040 0.040	1000	1000	Pos	
N-Cal: 0.876 Offset: 0.000	TATP2	4.440	5.071 -0.040 0.040	1000	1000	Pos	
P-Cal: 0.876 Offset: 0.000	DMNB	3.590	4.100 -0.050 0.050	2000	2000	Neg	
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	4.398 -0.120 0.120	2000	500	Neg	
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	6.150 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	P MNT 2	5.523	6.308 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	P MNT 3	5.127	5.856 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	DMNB 2	5.576	6.369 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	DMNB 3	5.358	6.120 -0.040 0.040	750	750	Neg	

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

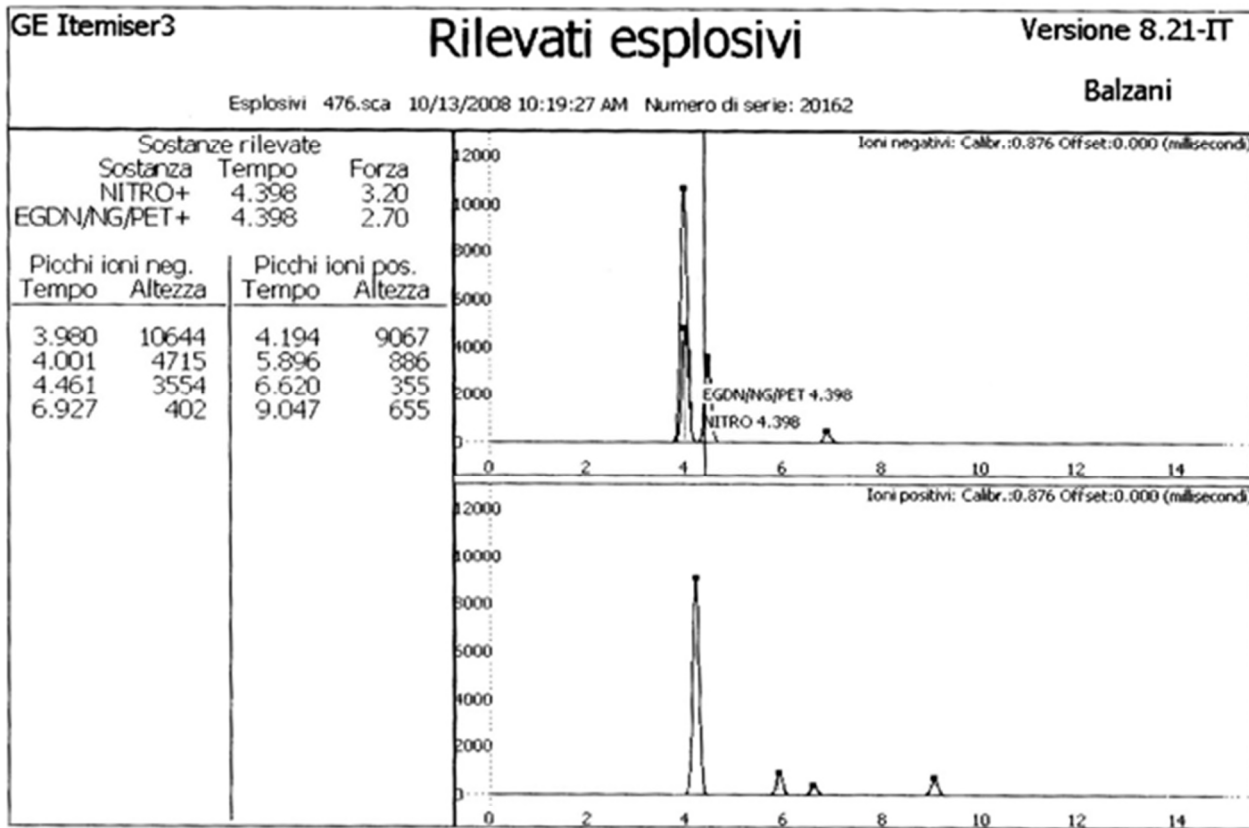

Note: 476

Nome file: 476.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:19:27 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:08:14 AM

Numero di serie: 20162

Esposivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.876 Offset: 0.000

P-Cal: 0.876 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.	All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	6.954 -0.060	0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.398 -0.120	0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.278 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.133 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
	3.870	4.420 -0.100	0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	8.091 -0.040	0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	6.408 -0.040	0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	4.659 -0.040	0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	5.071 -0.040	0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	4.100 -0.050	0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/PE	3.851	4.398 -0.120	0.120	2000	500	Neg
P MNT	5.385	6.150 -0.040	0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	6.308 -0.040	0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	5.856 -0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	6.368 -0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	6.119 -0.040	0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

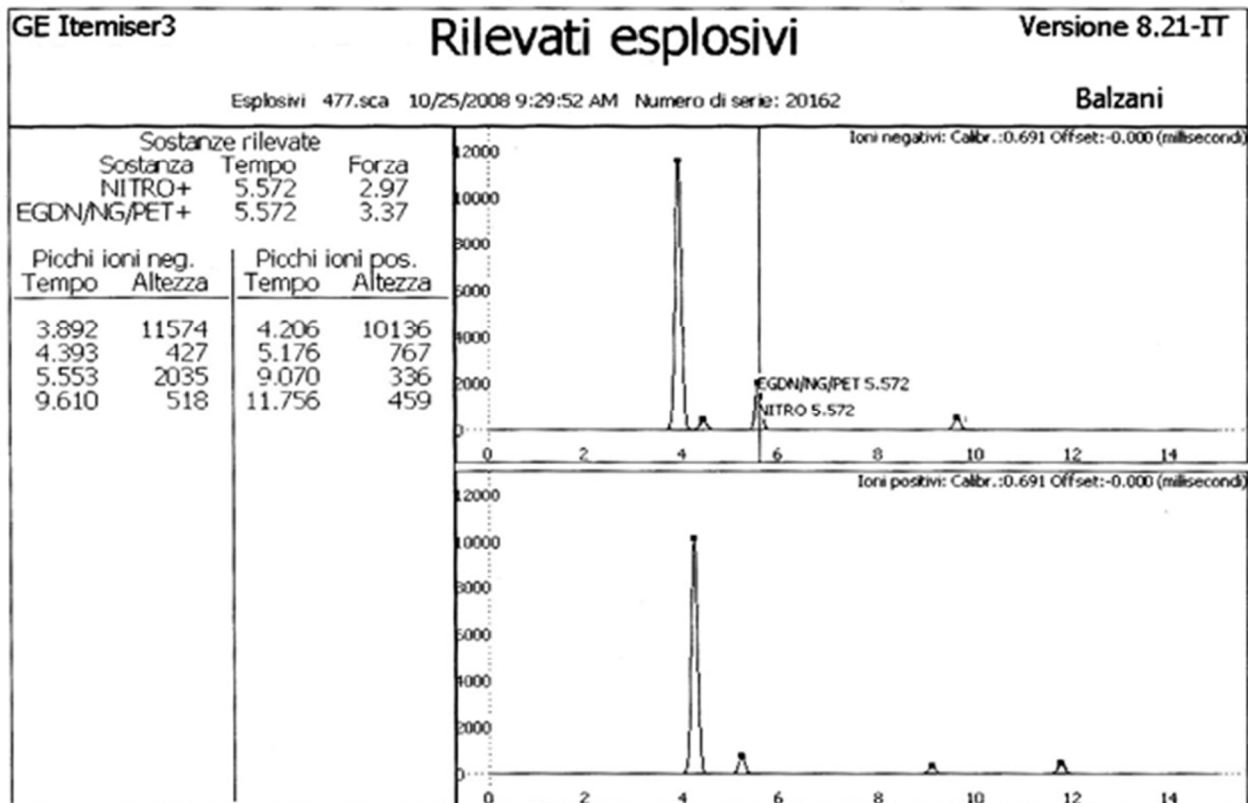

Note: 477

Nome file: 477.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.	All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	8.809 -0.060 0.040	600	550	Neg	
Tempo: 10/25/2008 9:29:52 AM	NITRO	3.851	5.572 -0.120 0.120	1000	500	Neg	
Calibr.: 10/25/2008 9:15:51 AM	RDX	6.372	9.219 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	11.570 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Esplosivi Ottimizzato		3.870	5.599 -0.100 0.100	1200	1000	Neg	
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	10.249 -0.040 0.040	750	750	Neg	
Avvisi:	DNT	5.611	8.118 -0.040 0.040	1000	1000	Neg	
Utente: Balzani	TATP	4.079	5.901 -0.040 0.040	1000	1000	Pos	
N-Cal: 0.691 Offset: -0.000	TATP2	4.440	6.424 -0.040 0.040	1000	1000	Pos	
P-Cal: 0.691 Offset: -0.000	DMNB	3.590	5.194 -0.050 0.050	2000	2000	Neg	
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	5.572 -0.120 0.120	600	500	Neg	
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	7.791 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	P MNT 2	5.523	7.991 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	P MNT 3	5.127	7.418 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	DMNB 2	5.576	8.067 -0.040 0.040	750	750	Neg	
	DMNB 3	5.358	7.752 -0.040 0.040	750	750	Neg	

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

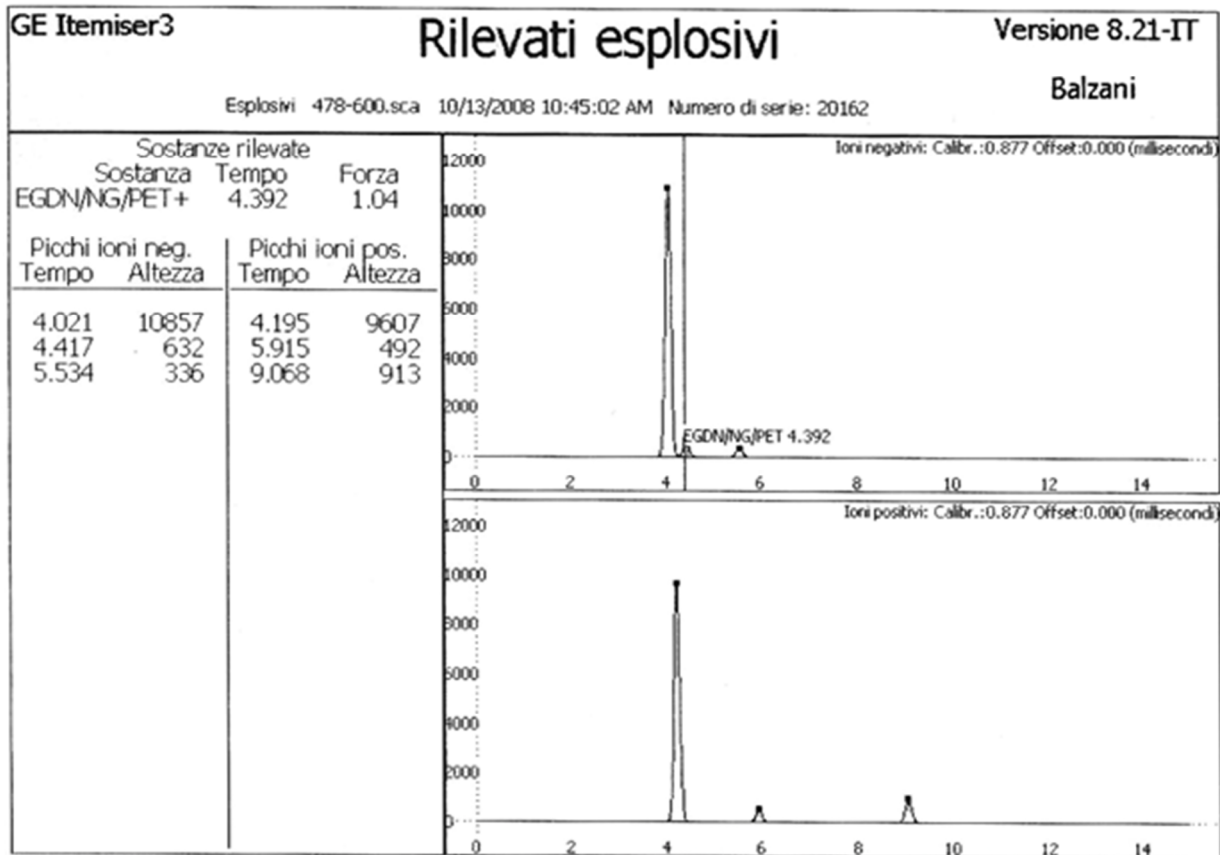

Note: 478-600

Nome file: 478-600.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv. All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	6.945 -0.060 0.040	600	550	Neg
Tempo: 10/13/2008 10:45:02 AM	NITRO	3.851	4.392 -0.120 0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 10/13/2008 10:40:47 AM	RDX	6.372	7.267 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	9.121 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Esplosivi Ottimizzato		3.870	4.414 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	8.080 -0.040 0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	6.400 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	4.652 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.877 Offset: 0.000	TATP2	4.440	5.064 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.877 Offset: 0.000	DMNB	3.590	4.095 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	4.392 -0.120 0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	6.142 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	6.299 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	5.848 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	6.360 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	6.111 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

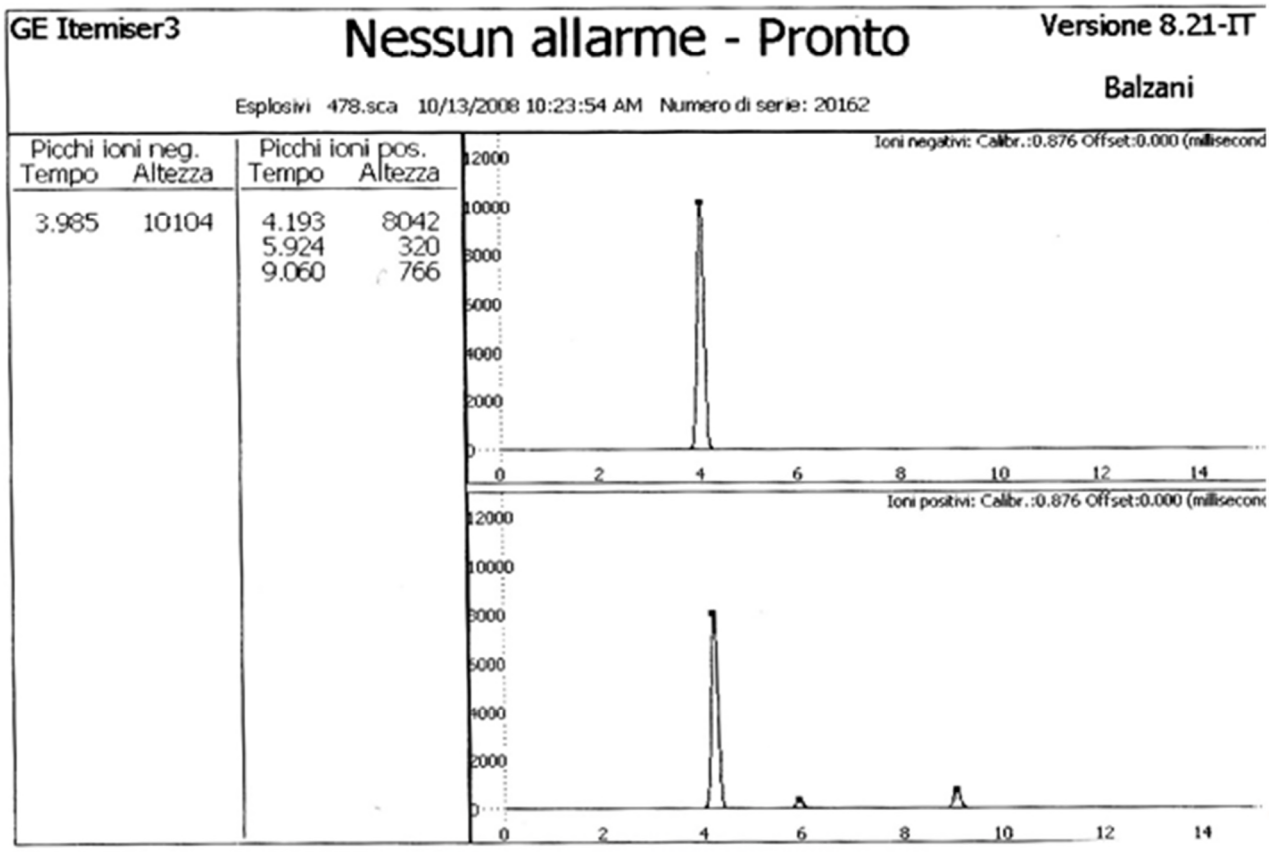

Note: 478

Nome file: 478.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:23:54 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:08:14 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.876 Offset: 0.000

P-Cal: 0.876 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	6.954 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.398 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.277 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.133 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
	3.870	4.420 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	8.091 -0.040 0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	6.408 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	4.659 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	5.071 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	4.100 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/PE	3.851	4.398 -0.120 0.120	2000	500	Neg
P MNT	5.385	6.150 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	6.308 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	5.856 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	6.368 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	6.119 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit



ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421


GE Itemiser3

Rilevati esplosivi

Versione 8.21-IT

Esplosivi 479.sca 10/25/2008 9:15:10 AM Numero di serie: 20162

Balzani

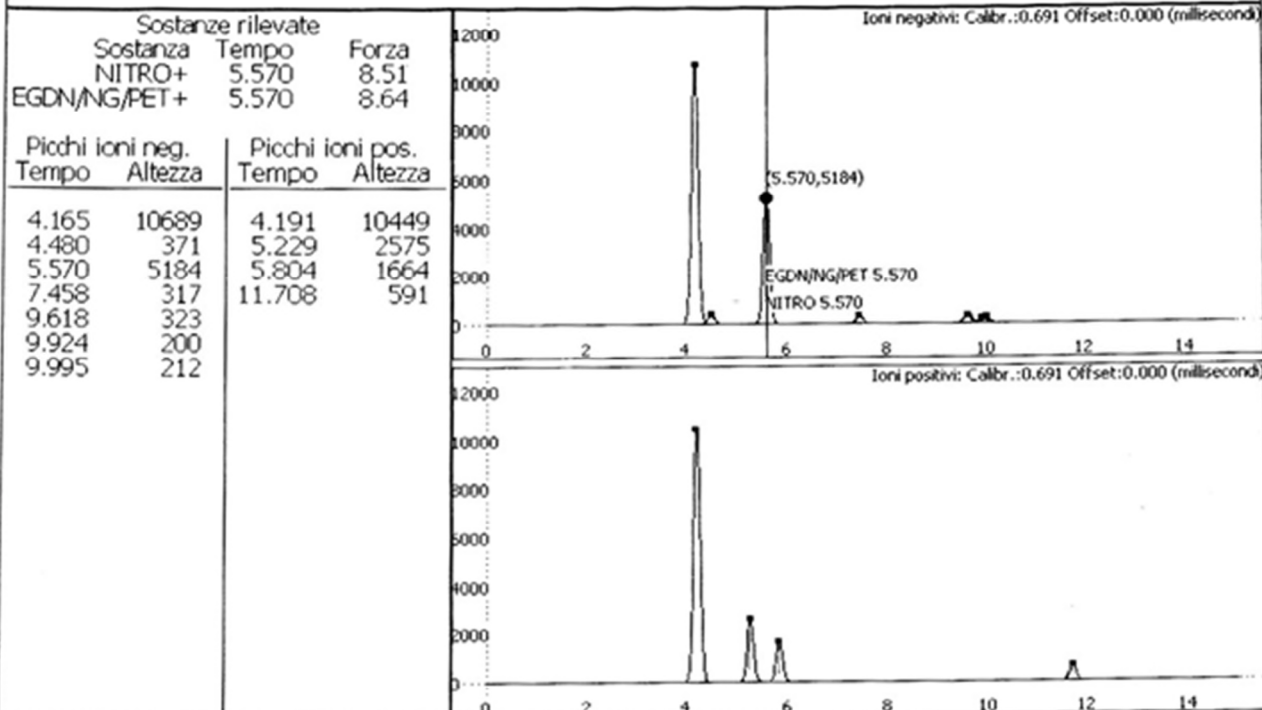

Note: 479-600

Nome file: 479.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/25/2008 9:15:10 AM

Calibr.: 10/25/2008 9:15:51 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.691 Offset: 0.000

P-Cal: 0.691 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	PosizionCalibr. (ms)				Liv.All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	8.807	-0.060	0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	5.570	-0.120	0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	9.217	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	11.567	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
	3.870	5.598	-0.100	0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	10.246	-0.040	0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	8.116	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	5.900	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	6.422	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	5.193	-0.050	0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/P	3.851	5.570	-0.120	0.120	600	500	Neg
P MNT	5.385	7.789	-0.040	0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	7.989	-0.040	0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	7.416	-0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	8.065	-0.040	0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	7.750	-0.040	0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

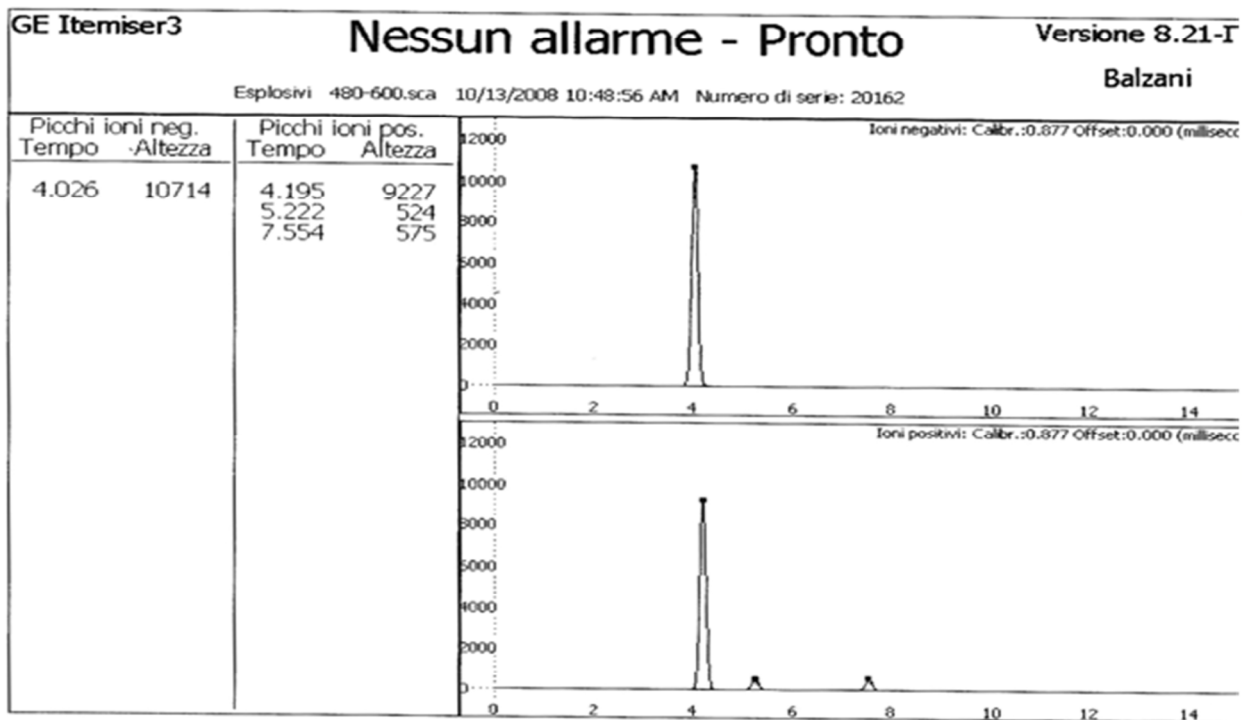

Note: 480-600

Nome file: 480-600.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modal
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	6.945 -0.060 0.040	600	550	Neg
Tempo: 10/13/2008 10:48:56 AM	NITRO	3.851	4.392 -0.120 0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 10/13/2008 10:40:47 AM	RDX	6.372	7.268 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	9.121 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Esplosivi Ottimizzato		3.870	4.414 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	8.080 -0.040 0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	6.400 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	4.652 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.877 Offset: 0.000	TATP2	4.440	5.064 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.877 Offset: 0.000	DMNB	3.590	4.095 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	4.392 -0.120 0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	6.142 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	6.299 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	5.848 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	6.360 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	6.111 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it – a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit



ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421


GE Itemiser3

Nessun allarme - Pronto

Versione 8.21-IT

Esplosivi 480.sca 10/13/2008 10:28:04 AM Numero di serie: 20162

Balzani

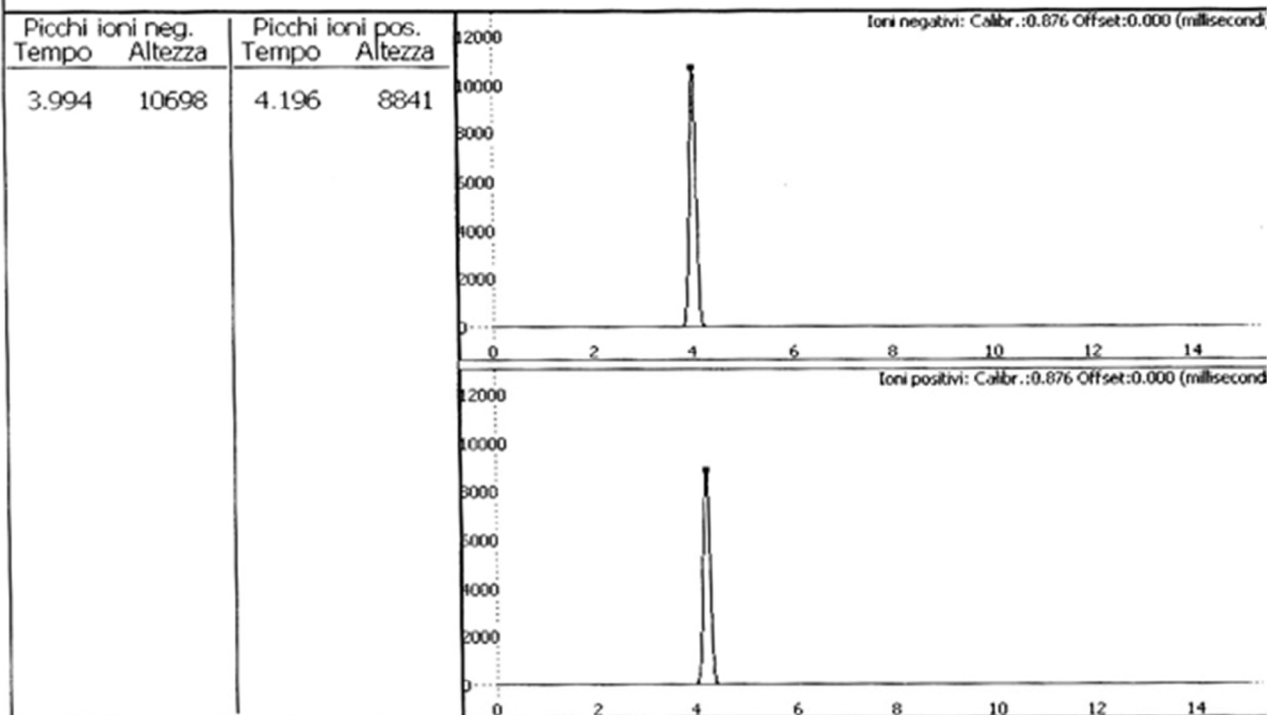

Note: 480

Nome file: 480.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:28:04 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:27:25 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.876 Offset: 0.000

P-Cal: 0.876 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	6.952 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.397 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.275 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.130 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
HMX	3.870	4.418 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
DNT	7.084	8.087 -0.040 0.040	750	750	Neg
TATP	5.611	6.406 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP2	4.079	4.657 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	4.440	5.069 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
EGDN/NG/PE	3.590	4.099 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
P MNT	3.851	4.397 -0.120 0.120	2000	500	Neg
P MNT 2	5.385	6.148 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.523	6.305 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.127	5.853 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.576	6.366 -0.040 0.040	750	750	Neg
	5.358	6.117 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

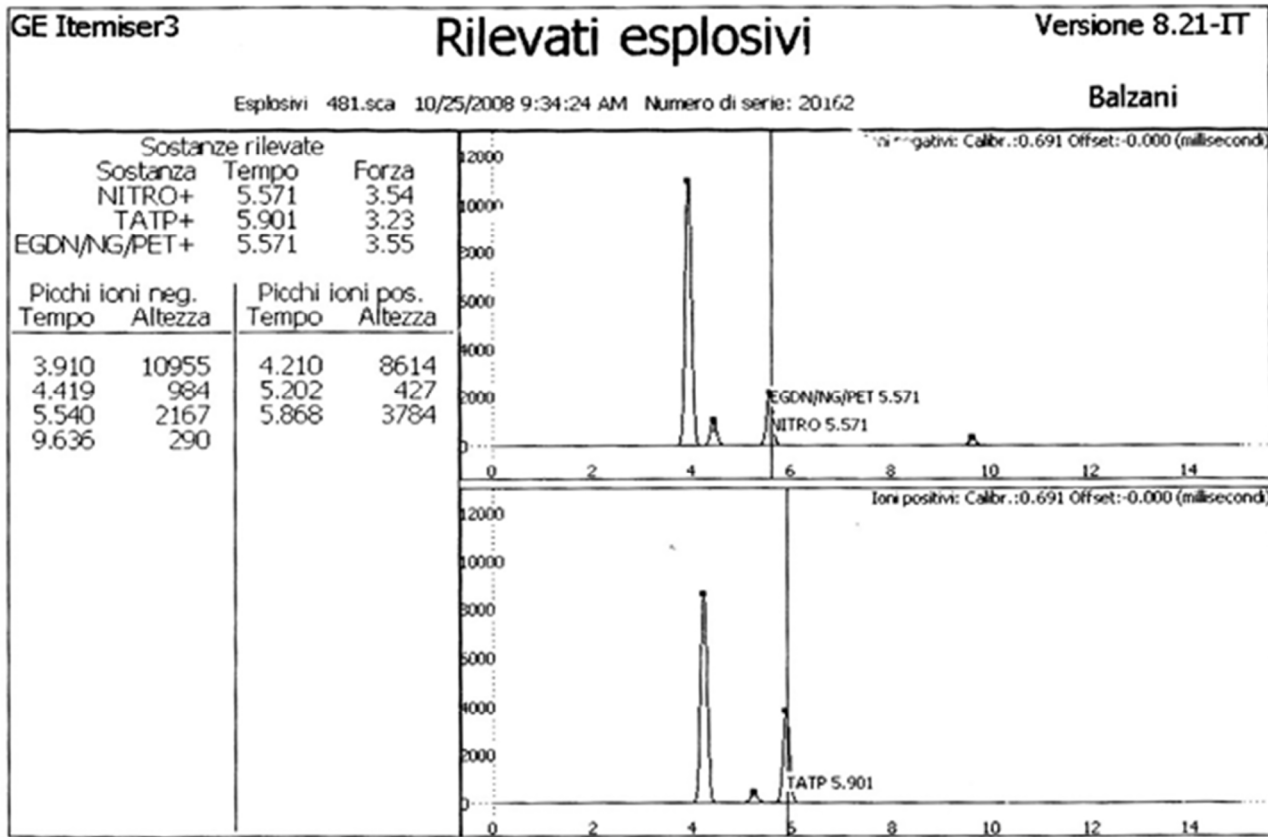

Note: 481

Nome file: 481.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	8.808 -0.060 0.040	600	550	Neg
Tempo: 10/25/2008 9:34:24 AM	NITRO	3.851	5.571 -0.120 0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 10/25/2008 9:15:51 AM	RDX	6.372	9.218 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	11.569 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Explosivi Ottimizzato		3.870	5.598 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	10.248 -0.040 0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	8.117 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	5.901 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.691 Offset: -0.000	TATP2	4.440	6.423 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.691 Offset: -0.000	DMNB	3.590	5.193 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	5.571 -0.120 0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	7.790 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	7.990 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	7.417 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	8.066 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	7.751 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

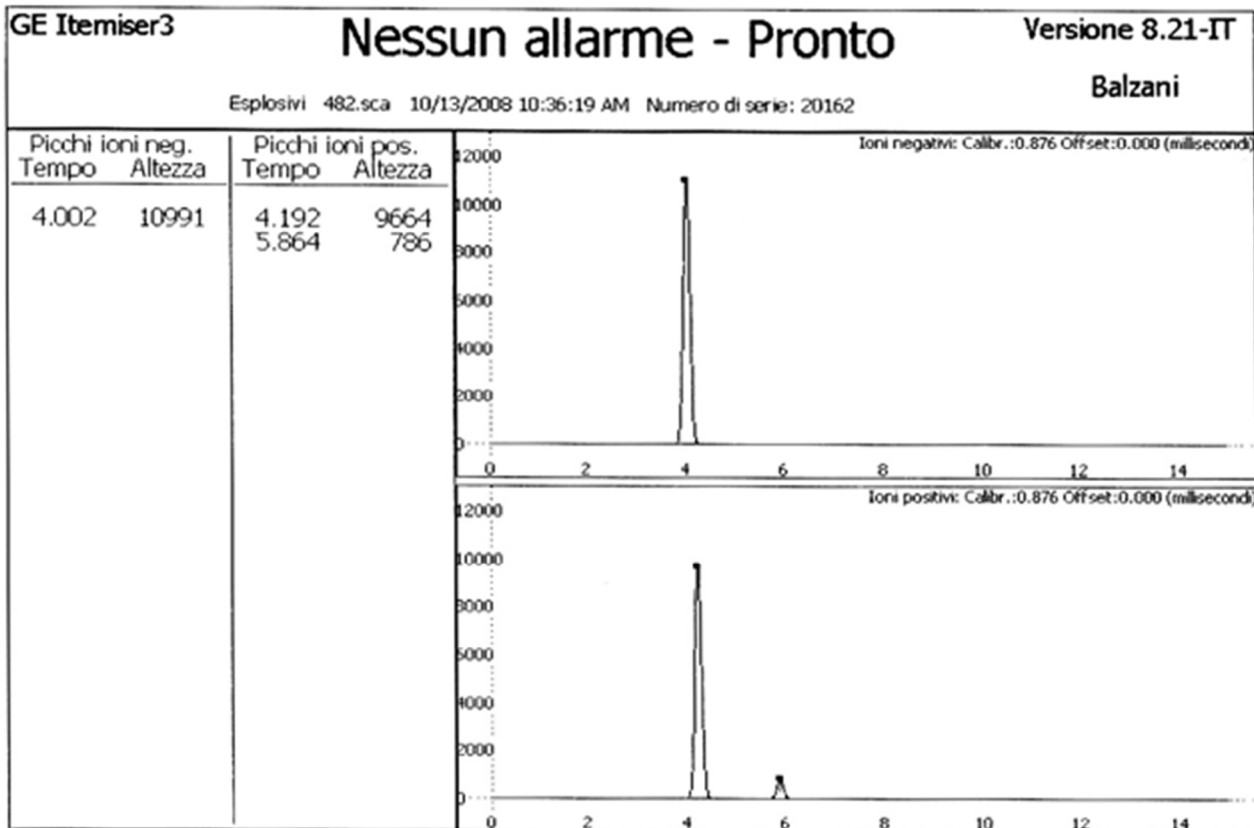

Note: 482

Nome file: 482.sca	Nome	PosizionCalibr. (ms)				Liv.All.	Rise	Modalit
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	6.952	-0.060	0.040	600	550	Neg
Tempo: 10/13/2008 10:36:19AM	NITRO	3.851	4.397	-0.120	0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 10/13/2008 10:27:25 AM	RDX	6.372	7.275	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	9.130	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Explosivi Ottimizzato		3.870	4.418	-0.100	0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	8.088	-0.040	0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	6.406	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	4.657	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.876 Offset: 0.000	TATP2	4.440	5.069	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.876 Offset: 0.000	DMNB	3.590	4.099	-0.050	0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	4.397	-0.120	0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	6.148	-0.040	0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	6.305	-0.040	0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	5.853	-0.040	0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	6.366	-0.040	0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	6.117	-0.040	0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

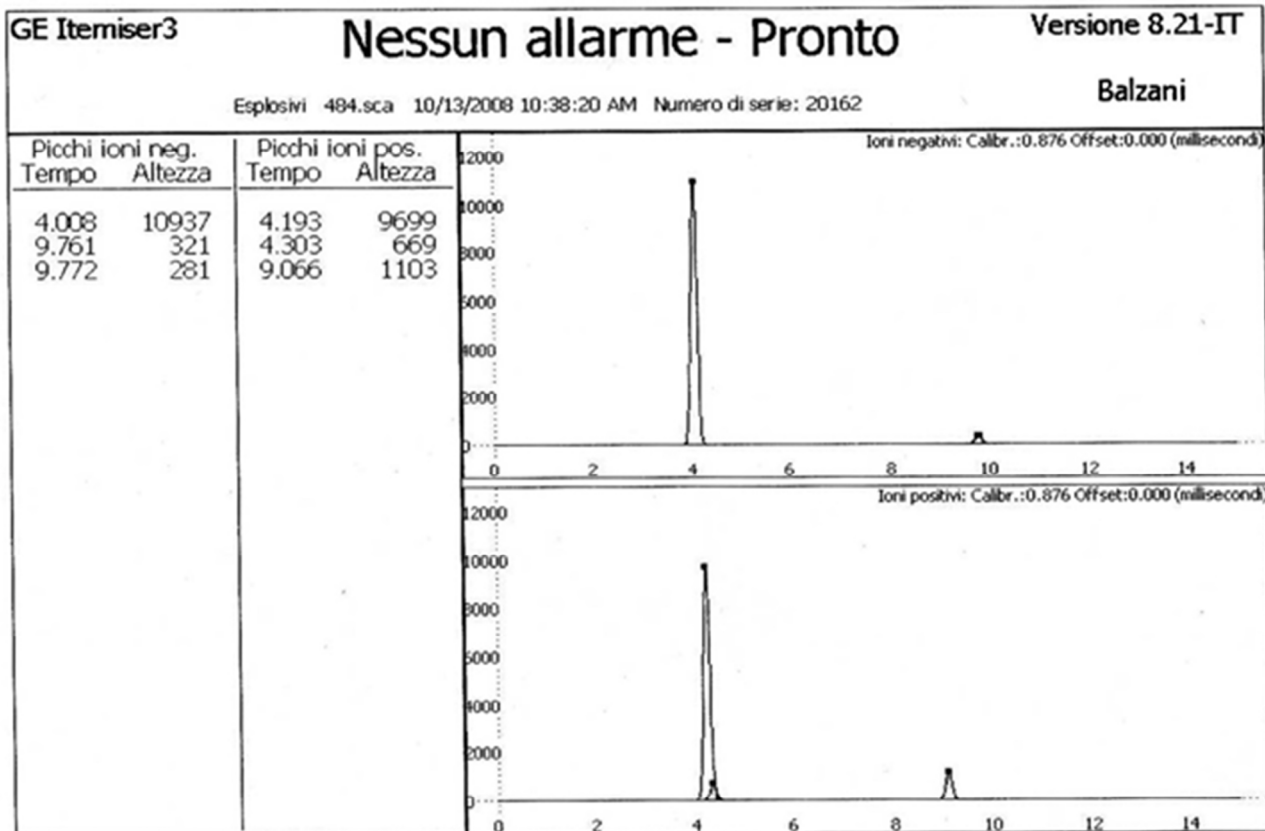

Note: 484

Nome file: 484.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 10/13/2008 10:38:20 AM

Calibr.: 10/13/2008 10:27:25 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.876 Offset: 0.000

P-Cal: 0.876 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modal
TNT	6.089	6.951 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	4.396 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	7.275 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	9.130 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
	3.870	4.418 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	8.087 -0.040 0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	6.406 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	4.657 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	5.069 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	4.098 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/PE	3.851	4.396 -0.120 0.120	600	500	Neg
P MNT	5.385	6.148 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	6.305 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	5.853 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	6.366 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	6.117 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

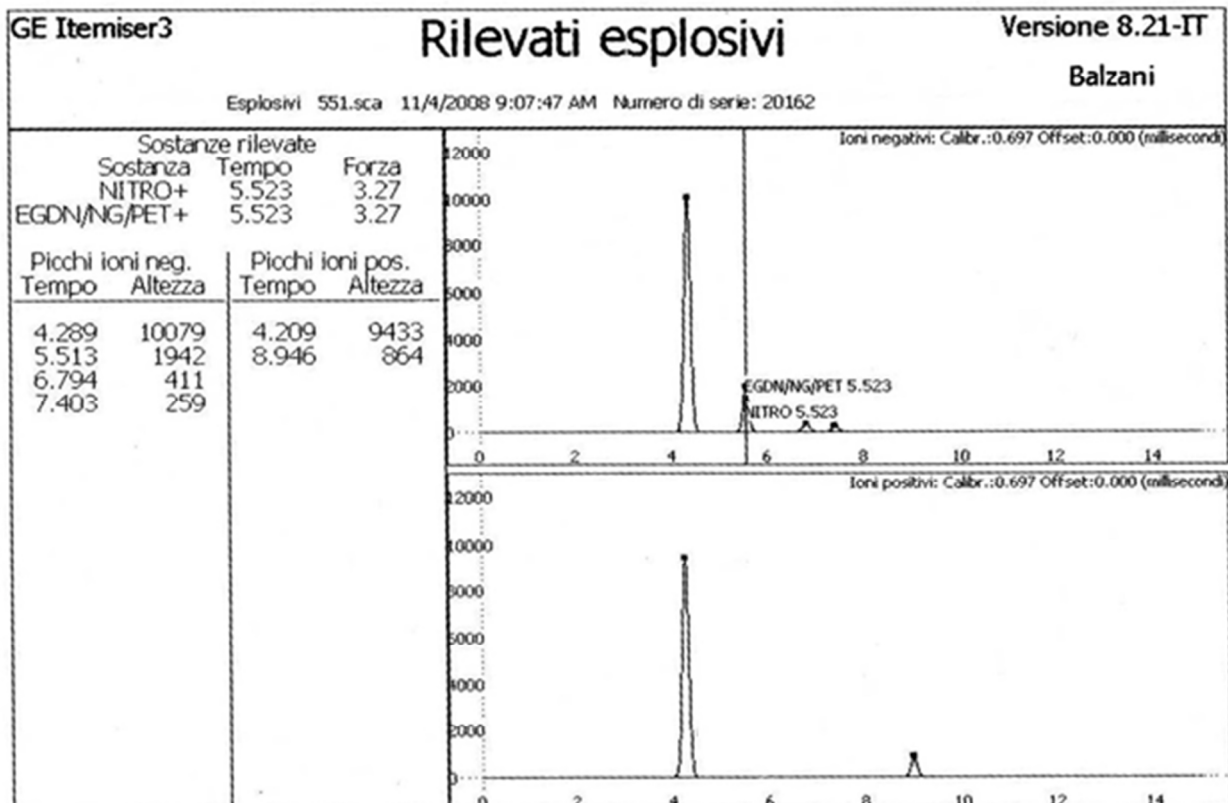

Note: 551

Nome file: 551.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 11/4/2008 9:07:47 AM

Calibr.: 11/4/2008 9:04:18 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.697 Offset: 0.000

P-Cal: 0.697 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizione	Calibr. (ms)	Liv. All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	8.732 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	5.523 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	9.138 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	11.469 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
HMX	3.870	5.550 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
DNT	7.084	10.159 -0.040 0.040	750	750	Neg
TATP	5.611	8.047 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP2	4.079	5.850 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	4.440	6.368 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
EGDN/NG/PE	3.590	5.149 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
P MNT	3.851	5.523 -0.120 0.120	600	500	Neg
P MNT 2	5.385	7.723 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.523	7.921 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.127	7.353 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.576	7.997 -0.040 0.040	750	750	Neg
	5.358	7.684 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it – a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

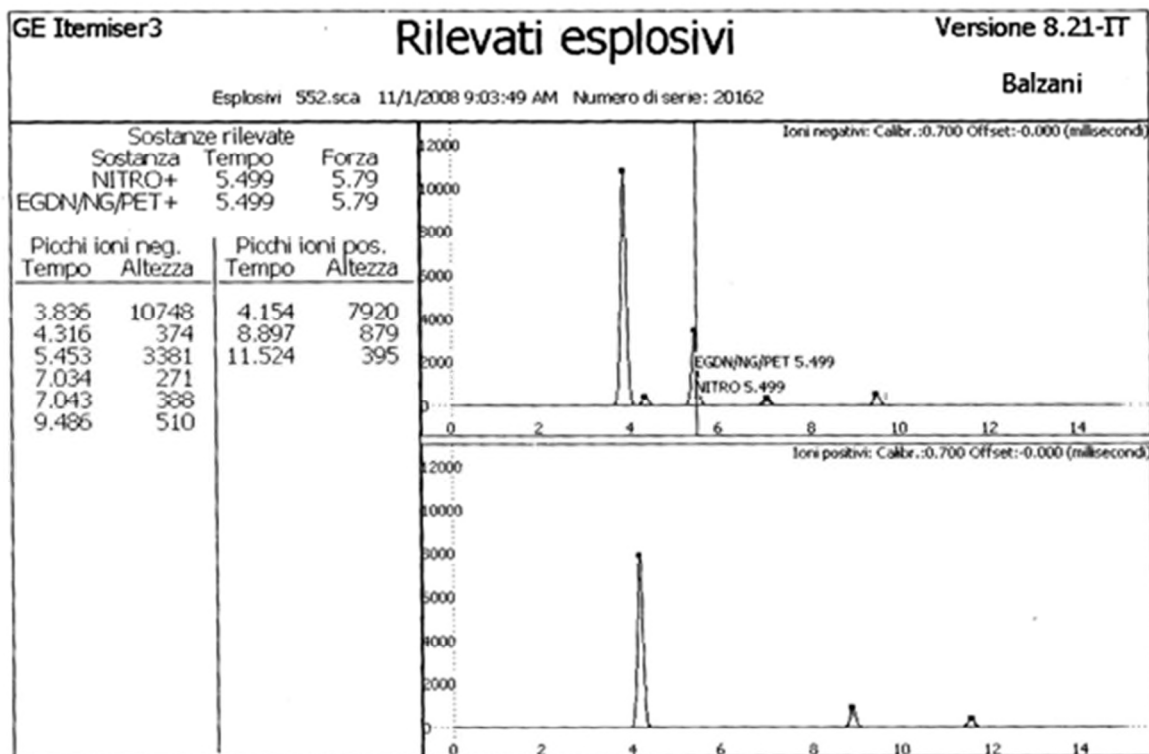

Note: 552

Nome file: 552.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 11/1/2008 9:03:49 AM

Calibr.: 11/1/2008 8:59:44 AM

Numero di serie: 20162

Esplosivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.700 Offset: -0.000

P-Cal: 0.700 Offset: -0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
TNT	6.089	8.694 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	5.499 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	9.098 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	11.419 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
	3.870	5.526 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
HMX	7.084	10.115 -0.040 0.040	750	750	Neg
DNT	5.611	8.012 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP	4.079	5.824 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
TATP2	4.440	6.340 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	3.590	5.126 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
EGDN/NG/PE	3.851	5.499 -0.120 0.120	600	500	Neg
P MNT	5.385	7.689 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 2	5.523	7.886 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.127	7.321 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.576	7.962 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.358	7.651 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc. BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

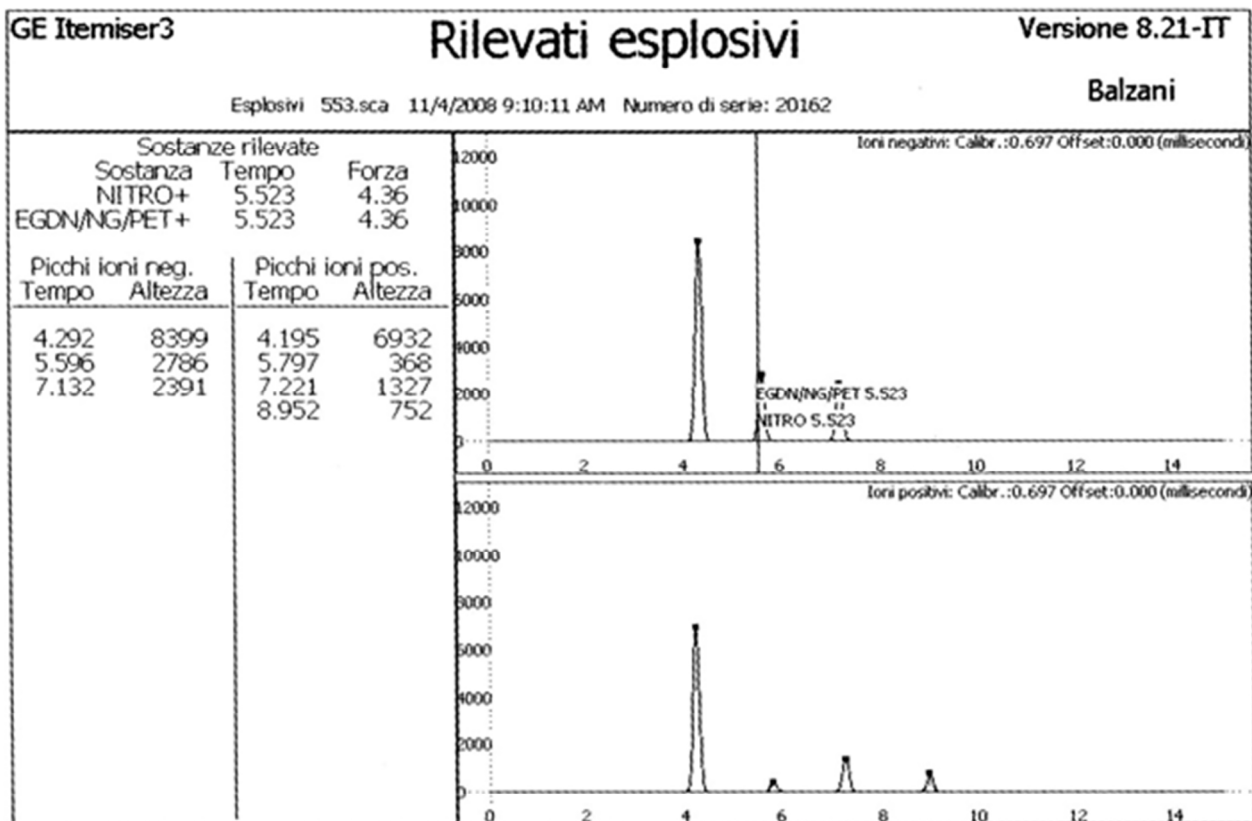

Note: 553

Nome file: 553.sca

Versione del software: 8.21-IT

Tempo: 11/4/2008 9:10:11 AM

Calibr.: 11/4/2008 9:04:18 AM

Numero di serie: 20162

Esposivi Ottimizzato

Tempo campionamento: 8.0 (s)

Avvisi:

Utente: Balzani

N-Cal: 0.697 Offset: 0.000

P-Cal: 0.697 Offset: 0.000

Temp. dell'unità desorbimento

Temp. del rilevatore: 162

Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalit
TNT	6.089	8.732 -0.060 0.040	600	550	Neg
NITRO	3.851	5.523 -0.120 0.120	1000	500	Neg
RDX	6.372	9.138 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
PETN	7.997	11.469 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
HMx	3.870	5.550 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
DNT	7.084	10.159 -0.040 0.040	750	750	Neg
TATP	5.611	8.047 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
TATP2	4.079	5.850 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
DMNB	4.440	6.367 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
EGDN/NG/PE	3.590	5.148 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
P MNT	3.851	5.523 -0.120 0.120	600	500	Neg
P MNT 2	5.385	7.723 -0.040 0.040	750	750	Neg
P MNT 3	5.523	7.921 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 2	5.127	7.353 -0.040 0.040	750	750	Neg
DMNB 3	5.576	7.997 -0.040 0.040	750	750	Neg
	5.358	7.684 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

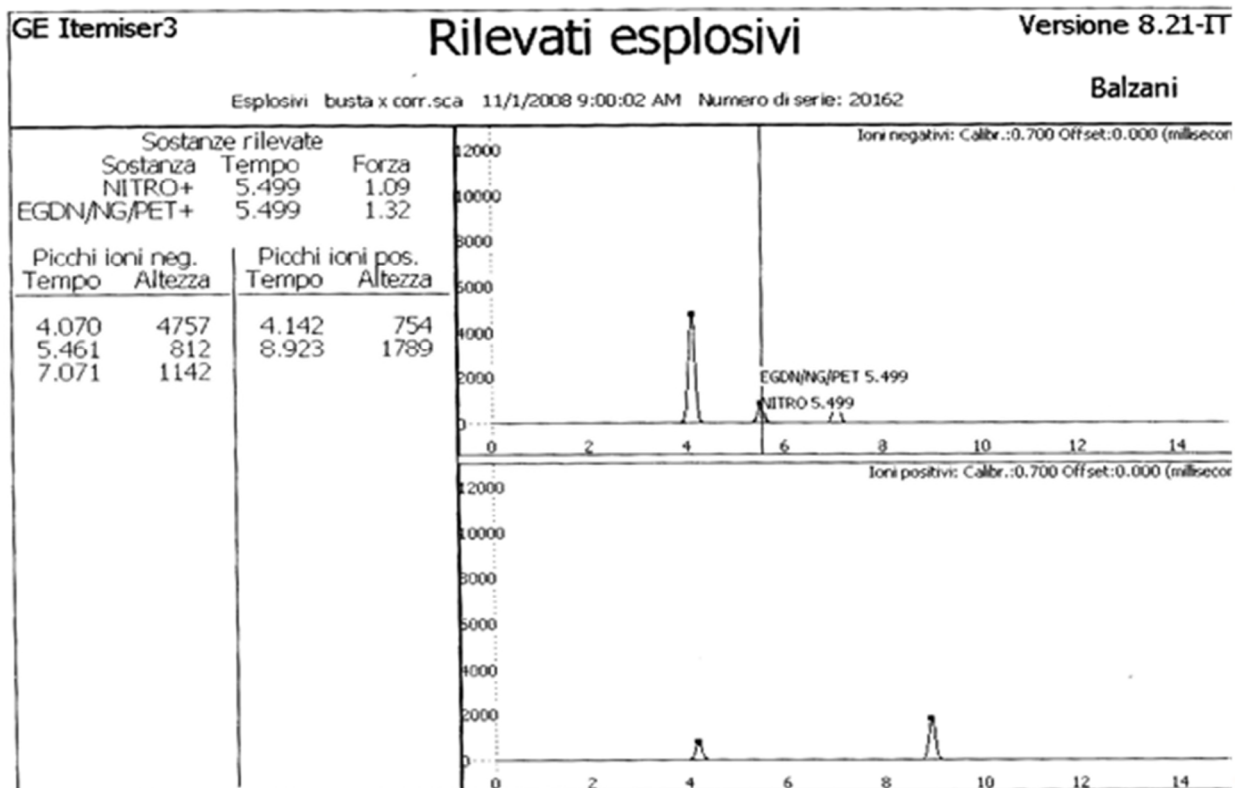

Note: x corr

Nome file: busta x corr.sca	Nome	Posizion	Calibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	8.694 -0.060 0.040	600	550	Neg
Tempo: 11/1/2008 9:00:02 AM	NITRO	3.851	5.499 -0.120 0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 11/1/2008 8:59:44 AM	RDX	6.372	9.098 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	11.419 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Esplosivi Ottimizzato		3.870	5.526 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	10.115 -0.040 0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	8.012 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	5.824 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.700 Offset: 0.000	TATP2	4.440	6.340 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.700 Offset: 0.000	DMNB	3.590	5.126 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	5.499 -0.120 0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	7.689 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	7.886 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	7.321 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	7.962 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	7.650 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit




ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421

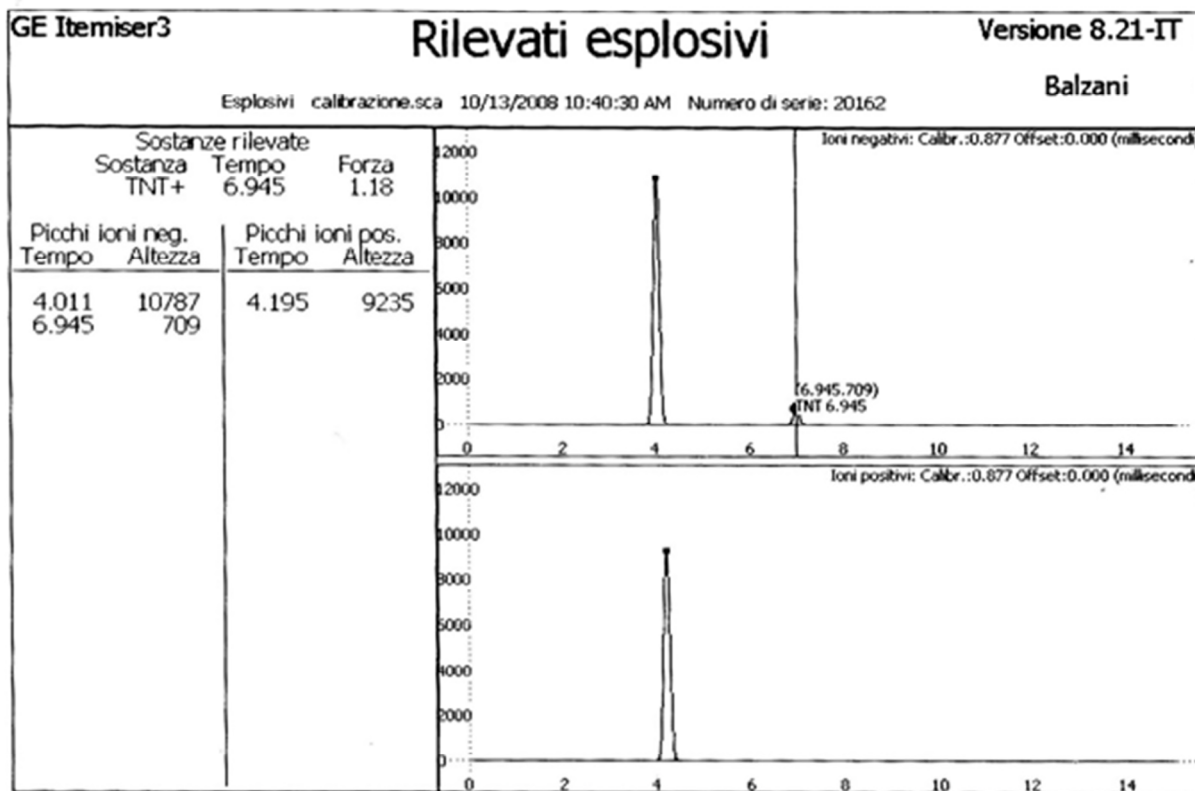

Note: calibrazione

Nome file: calibrazione.sca	Nome	PosizionCalibr. (ms)				Liv.All.	Rise	Moda
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089	6.945	-0.060	0.040	600	550	Neg
Tempo: 10/13/2008 10:40:30 AM	NITRO	3.851	4.392	-0.120	0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 10/13/2008 10:40:47 AM	RDX	6.372	7.268	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997	9.121	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Explosivi Ottimizzato		3.870	4.414	-0.100	0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084	8.080	-0.040	0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611	6.400	-0.040	0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079	4.652	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.877 Offset: 0.000	TATP2	4.440	5.064	-0.040	0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.877 Offset: 0.000	DMNB	3.590	4.095	-0.050	0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851	4.392	-0.120	0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385	6.142	-0.040	0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523	6.299	-0.040	0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127	5.848	-0.040	0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576	6.360	-0.040	0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358	6.111	-0.040	0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato




AIDII
associazione italiana degli igienisti industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit



ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





Dott. Antonio Balzani Cod. Fisc: BLZNTN52M16A646B p. Iva 00954760344 tel 335 371421



Note: calib NG

Nome file: calibrazione NG.sca	Nome	PosizionCalibr. (ms)	Liv.All.	Rise	Modalità
Versione del software: 8.21-IT	TNT	6.089 8.733 -0.060 0.040	600	550	Neg
Tempo: 11/4/2008 9:05:28 AM	NITRO	3.851 5.523 -0.120 0.120	1000	500	Neg
Calibr.: 11/4/2008 9:04:18 AM	RDX	6.372 9.138 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Numero di serie: 20162	PETN	7.997 11.469 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Esposivi Ottimizzato		3.870 5.550 -0.100 0.100	1200	1000	Neg
Tempo campionamento: 8.0 (s)	HMX	7.084 10.160 -0.040 0.040	750	750	Neg
Avvisi:	DNT	5.611 8.047 -0.040 0.040	1000	1000	Neg
Utente: Balzani	TATP	4.079 5.850 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
N-Cal: 0.697 Offset: -0.000	TATP2	4.440 6.368 -0.040 0.040	1000	1000	Pos
P-Cal: 0.697 Offset: -0.000	DMNB	3.590 5.149 -0.050 0.050	2000	2000	Neg
Temp. dell'unità desorbimento	EGDN/NG/PE	3.851 5.523 -0.120 0.120	600	500	Neg
Temp. del rilevatore: 162	P MNT	5.385 7.723 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 2	5.523 7.921 -0.040 0.040	750	750	Neg
	P MNT 3	5.127 7.353 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 2	5.576 7.997 -0.040 0.040	750	750	Neg
	DMNB 3	5.358 7.684 -0.040 0.040	750	750	Neg

mail: gsa@rsadvnet.it - a.balzani@live.it

associato



AIDII
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
per l'igiene industriale e per l'ambiente
ente no profit



ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE

